
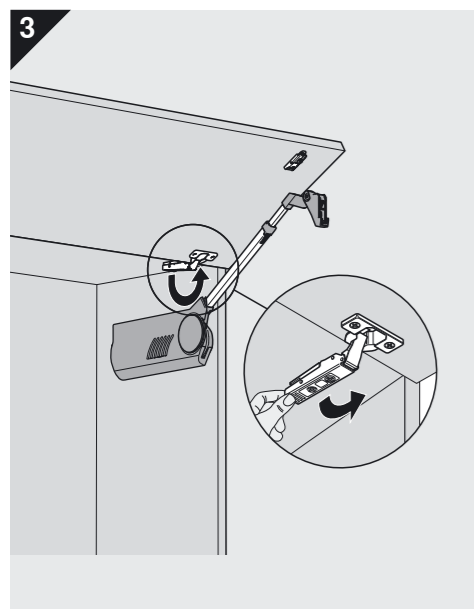




Demontage / Removal / Démontage / Smontaggio / Desmontaje

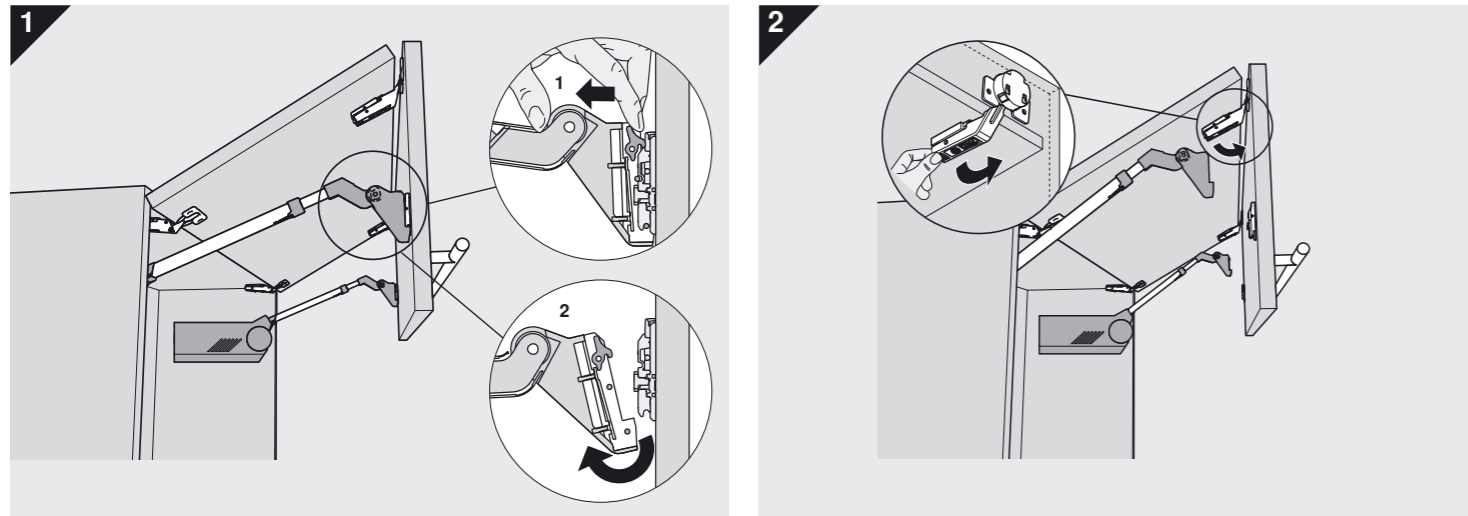

! Warning / Warning / Attention / Attenzione / Advertencia / 警告

Verletzungsgefahr durch hochspringenden Teleskophebel!
 Risk of injury by spring-loaded telescopic arm!
 Risque de blessure en cas de relevage brusque du bras télescopique!
 Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto verso l'alto della leva telescopica!
 Peligro de lesiones por salto de la palanca telescópica.
 アームが跳ね上がってケガをする可能性があります。

Teleskophebel nicht nach unten drücken, sondern entfernen.
 Do not push telescopic arm down without door attached but remove.
 Ne pas pousser le bras télescopique vers le bas, mais le retirer.
 Non spingere la leva telescopica verso il basso, altrimenti rimuoverlo.
 No apretar la palanca telescópica hacia abajo, si no retirarlo.
 アームを外す時は下に押さないでください。

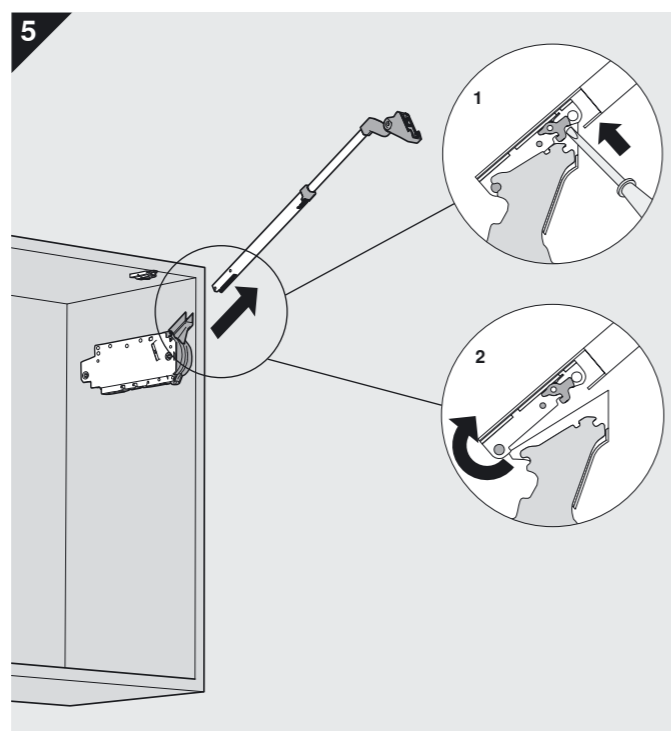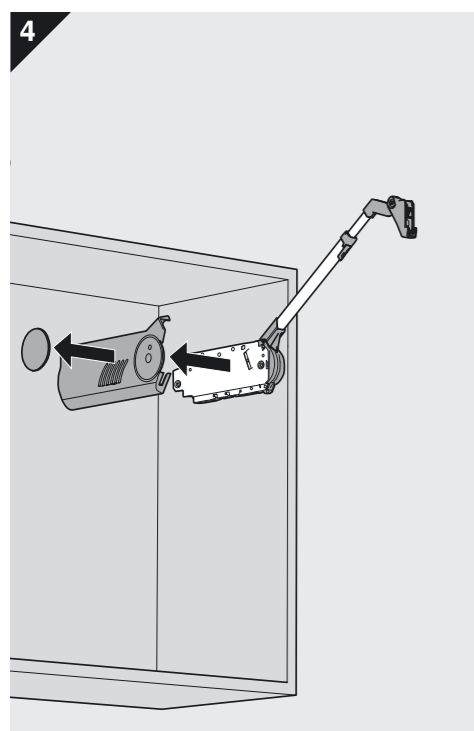


Julius Blum GmbH
 Beschlägefabrik
 A 6973 Höchst, Austria
 Tel.: +43 5578 705-0
 Fax: +43 5578 705-44
 E-Mail: info@blum.com
 www.blum.com




AVENTOS HF

Planung / Planning / Planification / Progettazione / Planificación

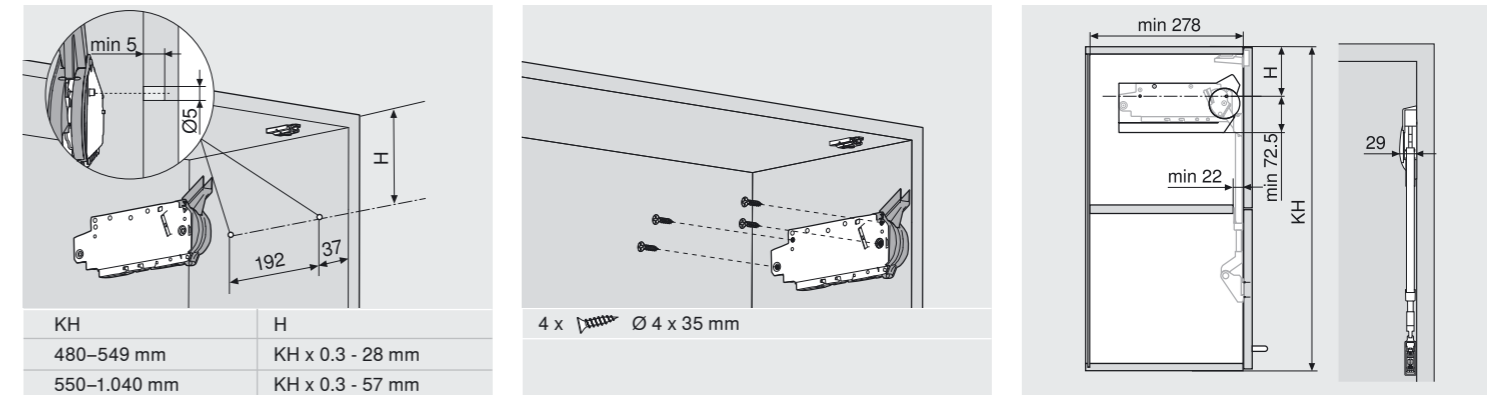


KH	H
480-549 mm	KH x 0.3 - 28 mm
550-1.040 mm	KH x 0.3 - 57 mm

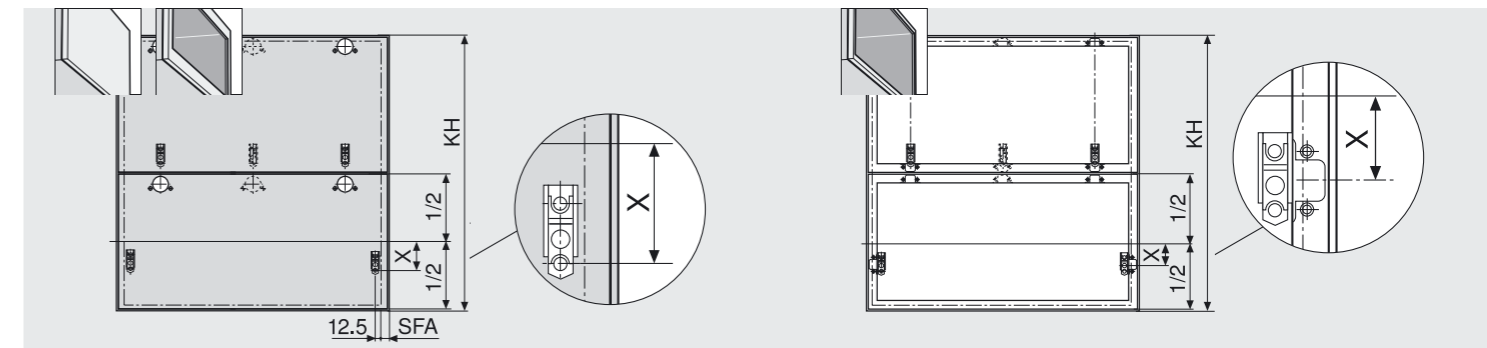


KH	X	X
480-549 mm	68 mm	70 mm
550-1.040 mm	45 mm	47 mm

KB	FG
3 x 1.200-1.799 mm	12-19 kg
4 x 1.800 mm	≥ 20 kg

KH	X
480-549 mm	54 mm
550-1.040 mm	31 mm

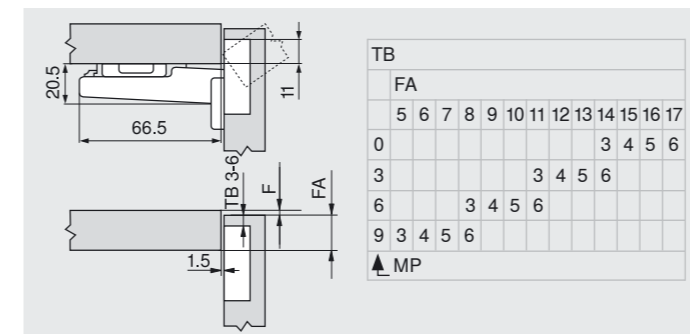


TB	FA
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15
15	16
16	17
0	3
3	4
4	5
5	6
6	3
3	4
4	5
5	6
9	3
3	4
4	5
5	6
▲ MP	

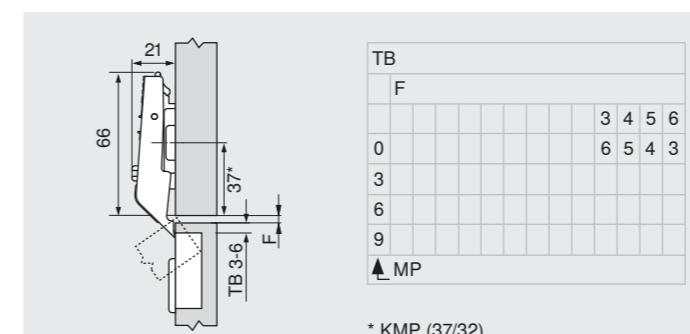

TB	F
0	3
3	4
4	5
5	6
6	3
3	4
4	5
5	6
9	3
3	4
4	5
5	6
▲ MP	

* KMP (37/32)


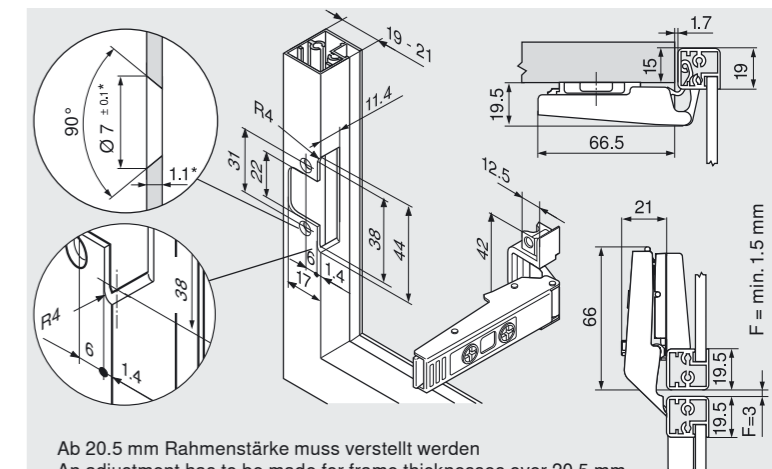


Ab 20.5 mm Rahmenstärke muss verstellt werden
 An adjustment has to be made for frame thicknesses over 20.5 mm
 Réglage nécessaire à partir d'une épaisseur de cadre de 20.5 mm
 È necessaria una regolazione a partire da uno spessore del telaio di 20.5 mm
 A partir de 20.5 mm resulta necesario ajustar el espesor del marco


* Bei Veränderung der Materialstärke die Bearbeitungsmaße anpassen
 When changing material thickness, adjust the assembly dimensions accordingly
 En cas de modification de l'épaisseur du matériau, adapter les dimensions d'usinage
 In caso di modifica dello spessore del materiale adattare la quota di lavorazione
 Adaptar las medidas de elaboración a los distintos espesores del material

F	Fuge / gap / jeu / fuga / juego	KMP	Kreuzmontageplatte / cruciform mounting plates / embases en croix / piastrina di premontaggio a croce / bases en cruz
FA	Frontaufschlag / front overlay / recouvrement / battuta frontale / recubrimiento del frente	MP	Montageplatte / mounting plate / embase / piastrina di premontaggio / base
FG	Frontgewicht / door weight / poids de face / peso del frontale / peso de frentes	SFA	Seitlicher Frontaufschlag / side front overlay / recouvrement latéral / sormonto laterale / recubrimiento lateral del frente
H	Höhe / height / hauteur / altezza / altura	TB	Topabstand / drilling distance / distance du boîtier / distancia fondello / distancia de cazoleta
KB	Korpusbreite / carcass width / largeur corps de meuble / larghezza corpo mobile / ancho cuerpo de mueble		
KH	Korpushöhe / cabinet height / hauteur corps de meuble / altezza del corpo mobile / altura de cuerpo de mueble		

Montage / Assembly / Montage / Montaggio / Montaje

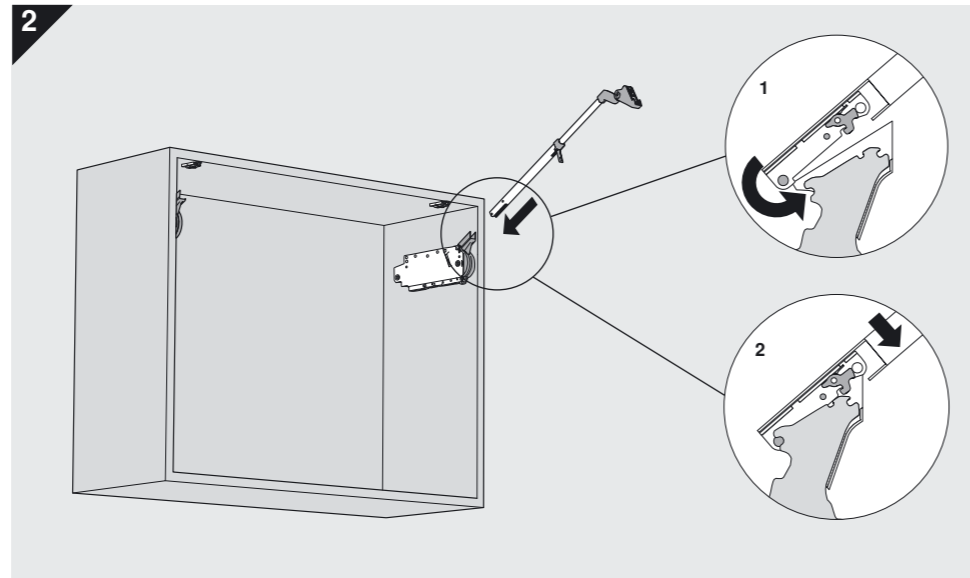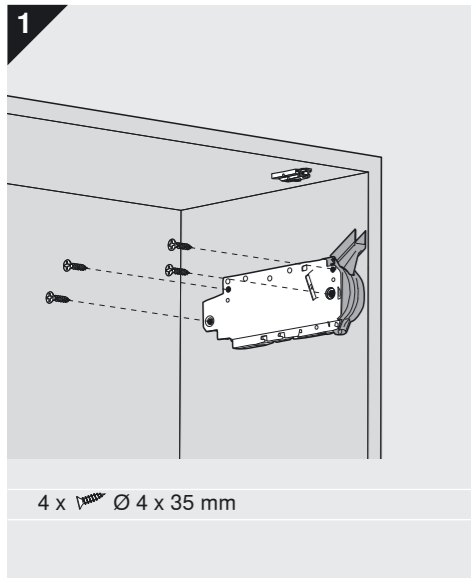










! Warning / Warning / Attention / Attenzione / Advertencia / 警告



Verletzungsgefahr durch hochspringenden Teleskophebel!
 Risk of injury by spring-loaded telescopic arm!
 Risque de blessure en cas de relevage brusque du bras télescopique!
 Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto verso l'alto della leva telescopica!
 Peligro de lesiones por salto de la palanca telescópica.
 アームが跳ね上がってケガをする可能性があります。



Teleskophebel nicht nach unten drücken, sondern entfernen.
 Do not push telescopic arm down without door attached but remove.
 Ne pas pousser le bras télescopique vers le bas, mais le retirer.
 Non spingere la leva telescopica verso il basso, altrimenti rimuoverlo.
 No apretar la palanca telescópica hacia abajo, si no retirarlo.
 アームを外す時は下に押さないでください。

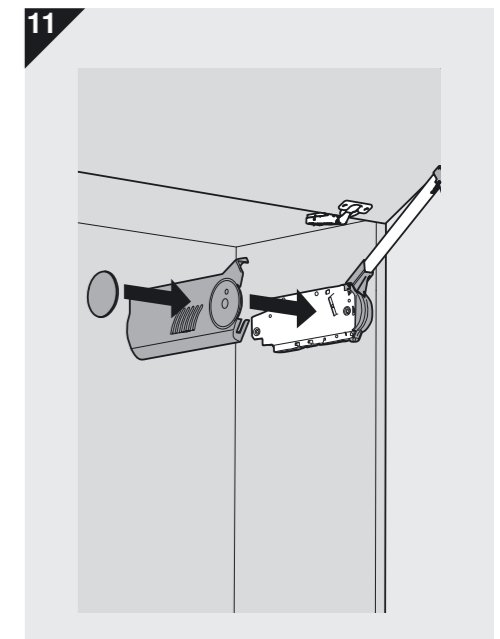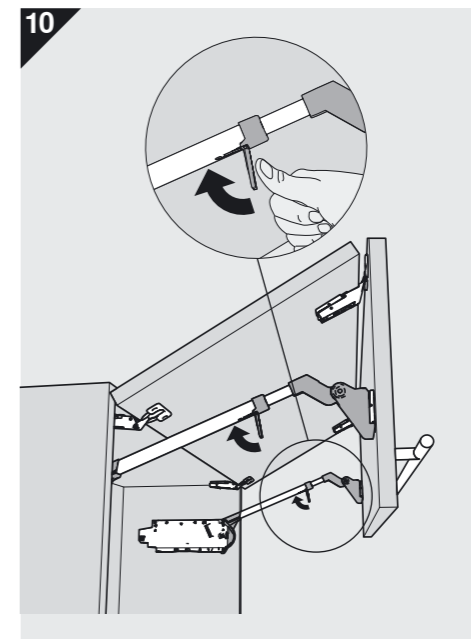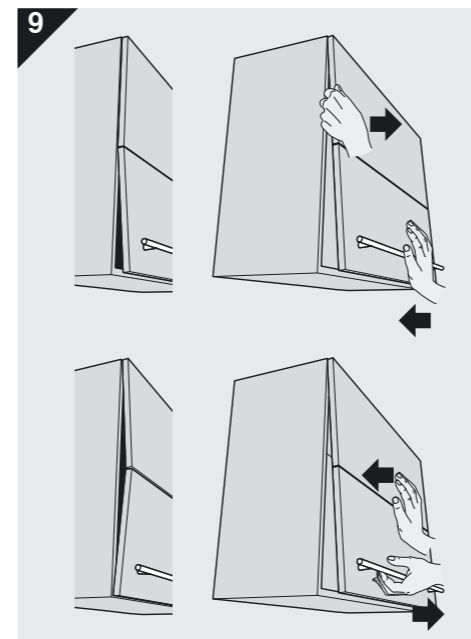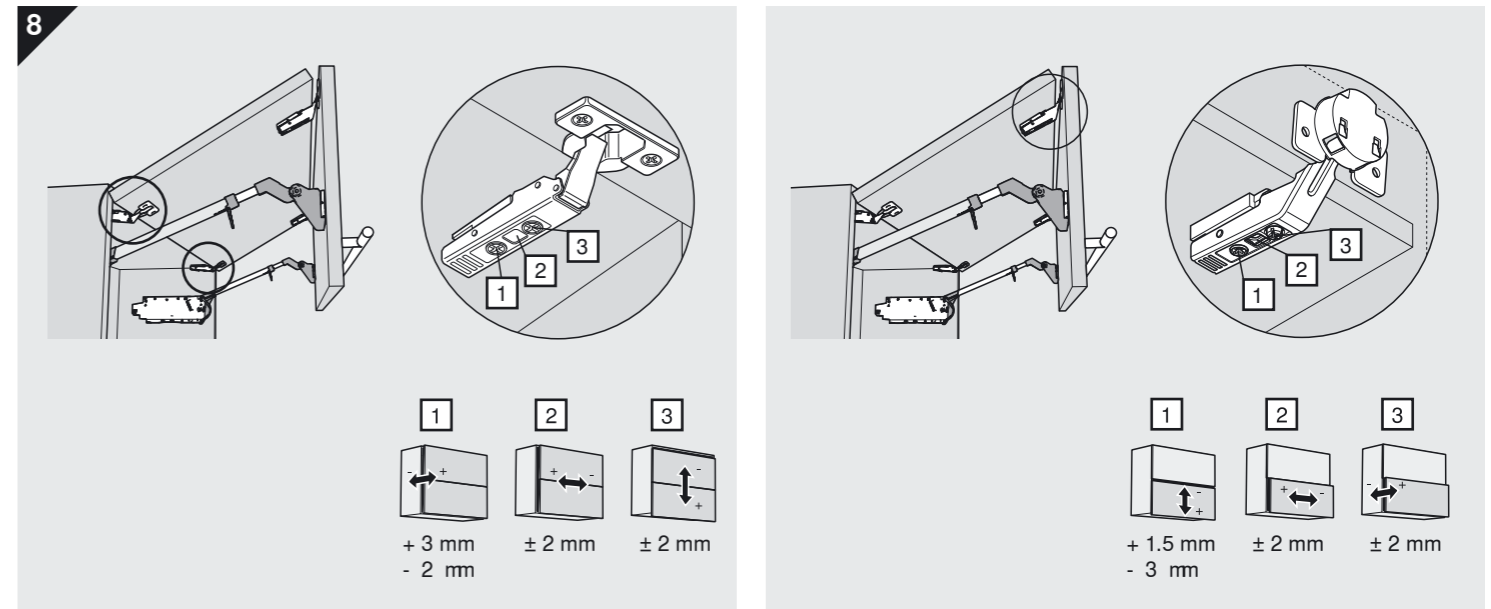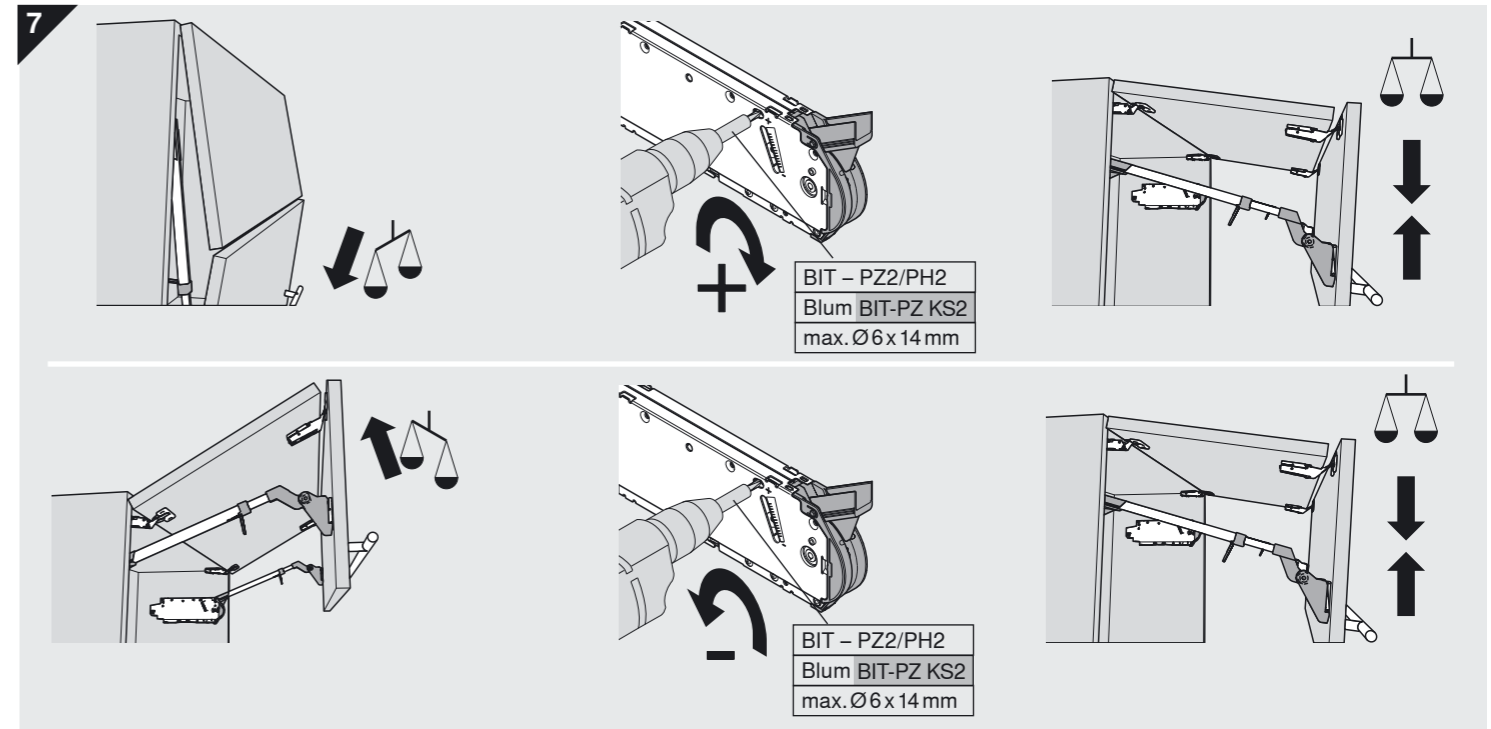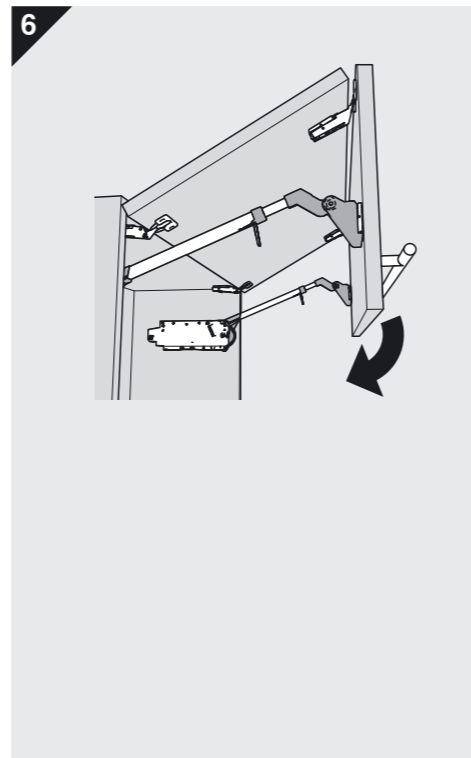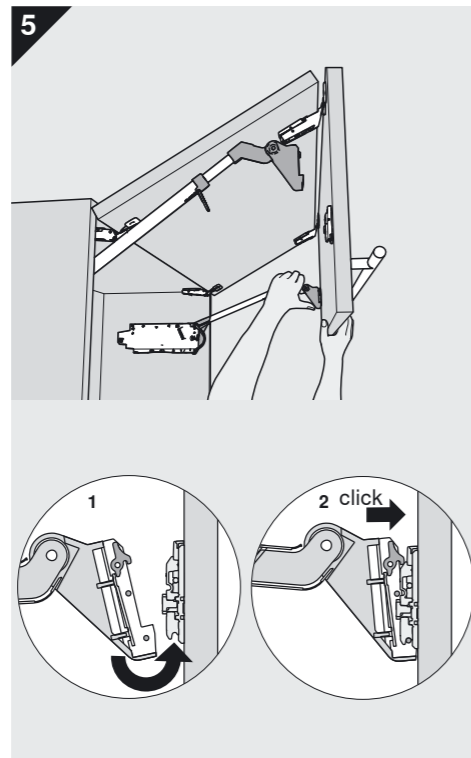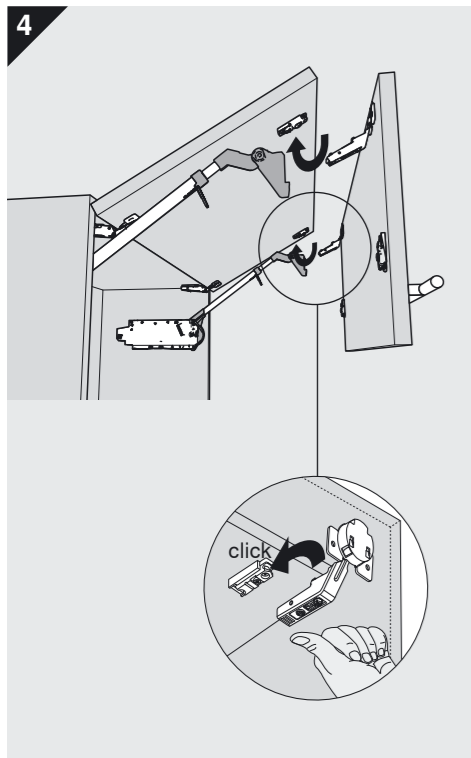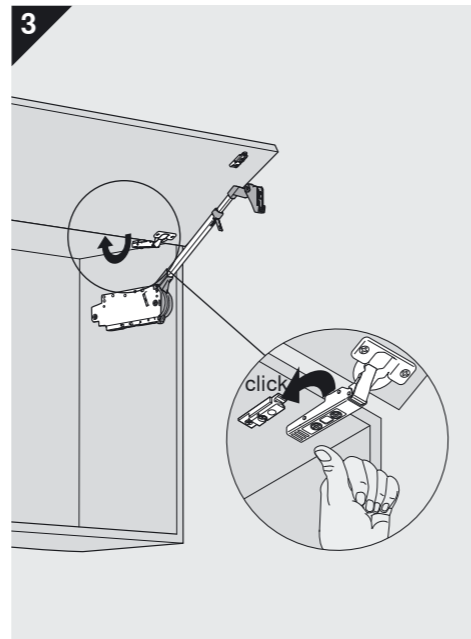

AVENTOS HF



AR	الذراع المتداخل يندفع بقوة مما قد يحدث جرح	لا تقوم بدفع الذراع المتداخل الى اسفل
BG	Опасност от нараняване при повдигане на телескопичната опора!	Телескопичната опора да не се натиска надолу, а да се отстранява.
CS	Nebezpečí zranění z důvodu vystřelujícího teleskopu!	Netlačte teleskop směrem dolů, nýbrž ji odstraňte.
DA	Risiko for at komme til skade ved opsvingning af teleskopstang!	Teleskopstang må ikke trykkes nedad, men fjernes.
DE	Verletzungsgefahr durch hochspringenden Teleskophebel!	Teleskophebel nicht nach unten drücken, sondern entfernen.
EL	Το τηλεσκοπικό μπράτσο μπορεί να πεταχτεί προς τα επάνω και να προκαλέσει τραυματισμό.	Μην σπρώχνετε προς τα κάτω το τηλεσκοπικό μπράτσο.
EN	Risk of injury by spring-loaded telescopic arm!	Do not push telescopic arm down without door attached.
ES	Peligro de lesiones por salto de la palanca telescópica.	No apretar la palanca telescópica hacia abajo, si no retirarlo.
ET	Teleskoophoob võib viskuda üles ja põhjustada trauma	Ära tõmba alla teleskoophooba.
FI	Loukkaantumisvaara – varsi voi ponnahtaa ylöspäin!	Älä paina vartta alaspäin, vaan se pitää poistaa!
FR	Risque de blessure en cas de relevage brusque du bras télescopique !	Ne pas pousser le bras télescopique vers le bas, mais le retirer.
HR	Opasnost od ozljeda uslijed teleskopske poluge koja iskače!	Teleskopsku polugu ne pritišćite prema dolje, već ga uklonite.
HU	Sérülésveszély a felugró teleszkópos emelőkar miatt!	A teleszkópos emelőkart nem szabad lefelé nyomni!
IT	Pericolo di lesioni a causa del possibile scatto verso l'alto della leva telescopica!	Non spingere la leva telescopica verso il basso, altrimenti rimuoverlo.
IW	הזרוע הטלסקופית עלולה לקפוץ כלפי מעלה ולגרום לפציעה	אסור לדחוף את הזרוע הטלסקופית כלפי מטה
JA	アームが跳ね上がってケガをする可能性があります。	アームを外す時は下に押さないでください。
LT	Teleskopinis svertas gali atšokti ir rimtai sužeisti.	Niekada nespaukite žemyn sverto.
LV	Teleskopiskais kronšteins var strauji atvērties uz augšu un radīt traumu.	Nespiediet uz leju teleskopisko kronšteinu.
NL	Risico tot kwetsuren door omhoogspringende telescopische arm!	Telescopische arm niet naar onder duwen maar verwijderen.
NO	Kraftig fjærpakke. Fare for skade !	Ikke press teleskoparmen ned ! Demonter før montering av skrog.
PL	Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie unoszący się podnośnik teleskopowy!	Nie opuszczać podnośnika teleskopowego.
PT	Perigo de ferimento, devido ao brusco salto da alavanca telescópica.	Não pressionar a alavanca telescópica para baixo, mas sim removê-la.
RO	Pericol de rănire prin brațul telescopic aflat sub tensiunea produsă de arcuri!	Nu apăsați în jos brațul telescopic, ci îndepărtați-l.
RU	Существует опасность травмы выскакивающим вверх телескопическим рычагом!	Не давите на телескопический рычаг вниз. В случае необходимости их следует снимать.
SK	Riziko poranenia kvôli vyskakujúcemu teleskopu!	Netlačte teleskop smerom dole, ale ich odstráňte.
SL	Nevarnost poškodbe zaradi teleskopske ročice, ki lahko odskoči!	Teleskopske ročice ne potiskajte navzdol, ampak ga odstranite.
SR	Opasnost od povreda usled iskakajuće teleskopske poluge!	Teleskopsku polugu ne pritiskati nadole, već skinuti.
SV	Skaderisk vid obelastad teleskoparm!	Tryck inte ned teleskoparmen, utan ta bort den.
TR	Teleskopik kol sıçrayabileceği için yaralanma tehlikesi!	Teleskopik kol aşağı doğru bastırılmamalıdır, çıkarılmalıdır.
UK	Загроза травмування з причини різкого піднімання телескопічного важеля!	Не опускати до низу телескопічний важіль. Його необхідно зняти.
ZH	伸缩臂上弹会伤害到人！	伸缩臂请勿下压，请务必取下。



WARNING 警告

